

# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-TZP-ZPP-26-21/20

Ostrołęka, dn. 27.07.2020r.

## Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) **na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

### Wniosek I

1. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oczekiwał od Oferentów dostarczenia "pakietu najbardziej zaawansowanych i najbardziej skutecznych specjalizowanych, zaawansowanych algorytmów właściwych dla danego producenta, działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i jednocześnie umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką". Zagwarantuje to najwyższą skuteczność minimalizowania dawki dla pacjenta i personelu przy jednoczesnej optymalizacji jakości obrazu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 11

Treść warunku w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania angiografu o zakresie projekcji CRAN/CAUD równym 110° w pozycji statywu z boku pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna najwyższą ocenę przypisaną do warunku w przypadku zaoferowania angiografu o czasie obrotu w trakcie wykonywania angiografii rotacyjnej równym 5 sekund.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

4. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 32,33 i 34


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna ocenę 20 punktów w przypadku zaoferowania angiografu o maksymalnych wartościach parametrów pojemności cieplnej anody, pojemności cieplnej kołpaka i maksymalnego obciążenia lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlania.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

5. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 48

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna ocenę 50 punktów w przypadku zaoferowania angiografu o maksymalnym efektywnym polu obrazowania. Wymiar płaskiego panelu detekcyjnego przekłada się wprost na korzyść w postaci możliwości maksymalnego obrazowania anatomii podczas pojedynczej projekcji. Eliminuje to potrzebę obrazowania rozległej anatomii w kilku ekspozycjach co ma korzystny wpływ na redukcję zarówno dawki jak i środka kontrastującego.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

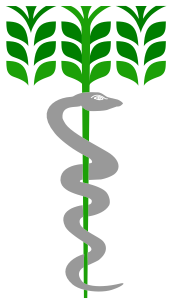

## MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69  
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616  
[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



6. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 49

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna ocenę 50 punktów w przypadku zaoferowania angiografu o maksymalnej wartości typowej DQE. Efektywność kwantowa DQE jest powszechnie uznanym parametrem wyrażającym skuteczność wykorzystania promieniowania jonizującego dla potrzeb obrazowania interwencyjnego. Maksymalizacja wartości tego parametru gwarantuje uzyskanie obrazu najwyższej jakości przy możliwie najmniejszych dawkach.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

7. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 61

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna ocenę 50 punktów w przypadku zaoferowania angiografu o maksymalnej wielkości matrycy akwizycyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

8. Pytanie do załącznika nr 3 do SIWZ pkt 145

Treść warunku w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania stołu o przezierności przezierności 360° dla blatu karbonowego w zakresie 1450mm. W ujęciu praktycznym, pacjent trafia na stół angiograficzny ze zdiagnozowaną jednostką chorobową, co oznacza znaną lokalizację anatomii będącej przedmiotem zabiegu. Jednocześnie podkreślamy, iż możliwość obrazowania rozległych obszarów anatomicznych, takich jak np kończyny dolne, Zamawiający zagwarantował w warunku 13, gdzie wymaga zapewnienia obszaru badania na zaoferowanym stole bez konieczności przekładania / przesuwania pacjenta (dla angulacji LAO/RAO - 0°, CRAN/CAUD - 0°) nie mniejszego niż 160 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**